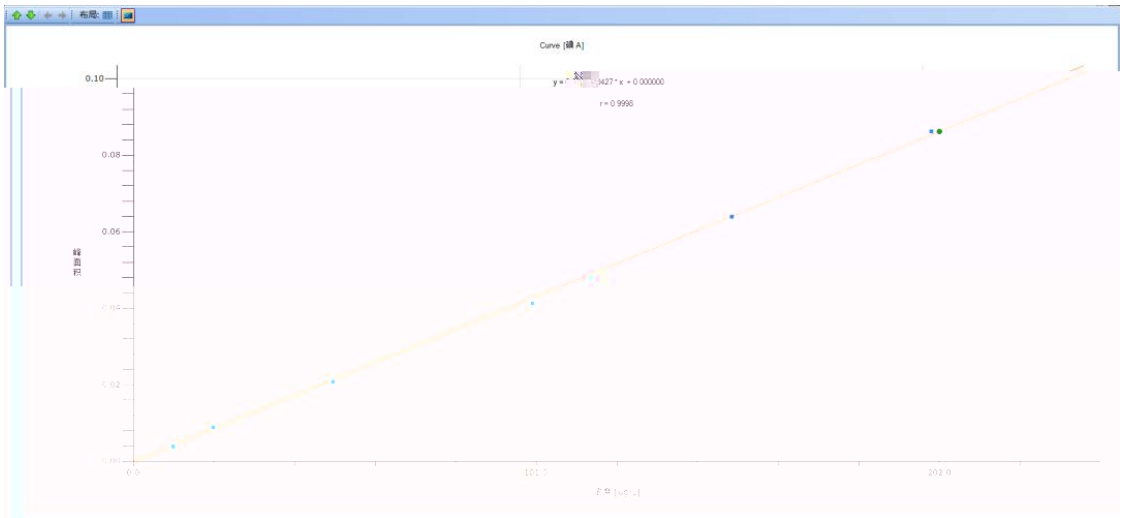
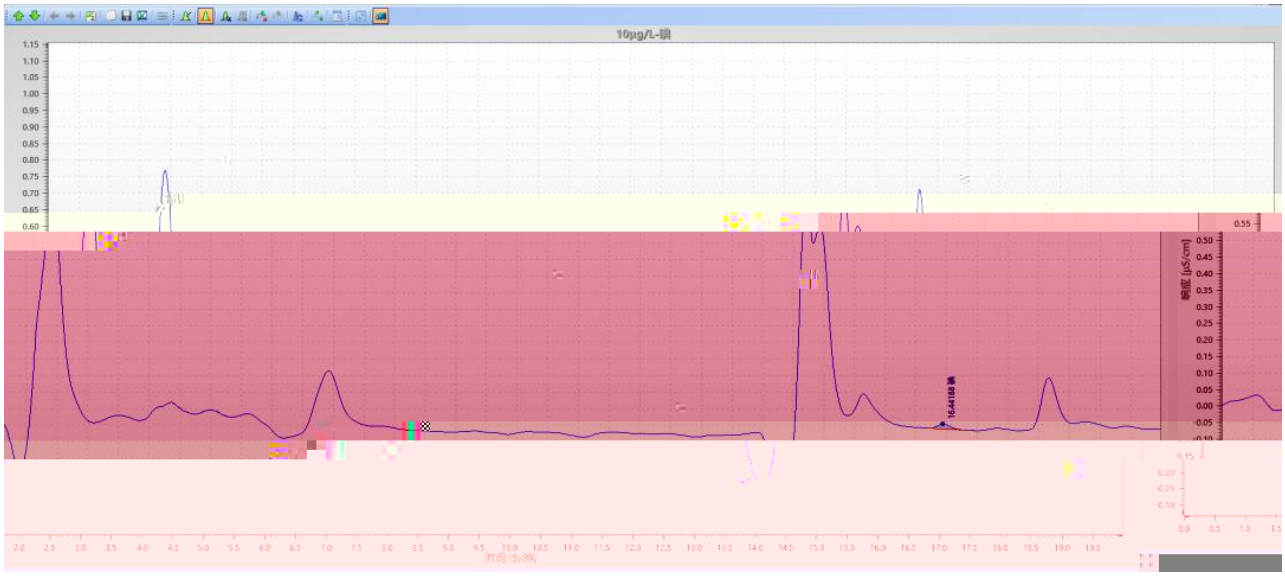
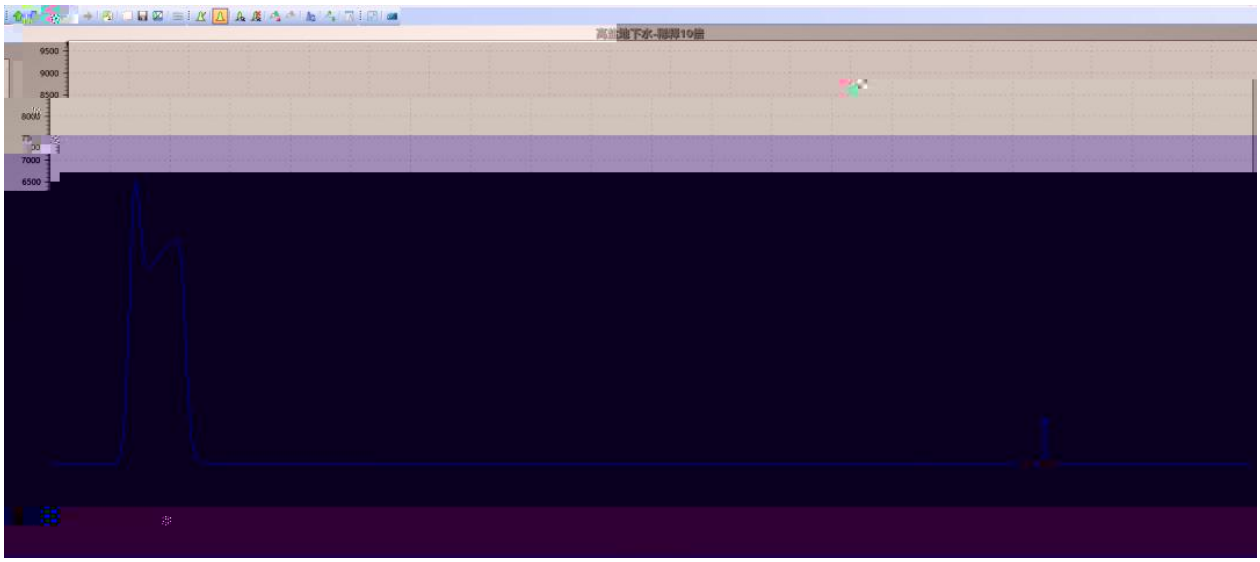



Electrodialytic Eluent Generator
Prin-Cen


取 1.0mL 样品，用超
向
将
再次将稀释后的样品 3mL 加入到 Na 萃取柱中，收集滤液，
测。


Curve (峰 A)
0.10
0.08
0.06
峰面积


10μg/L-银
时间/分钟


地下水-标样10倍



